



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES
 PRESENCIAL
 No. LP-919044992-I41-2016**

“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO”

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 11:00 horas del día 02 de diciembre del 2016, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en el 2do. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-I41-2016** referente a la adquisición de **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos en Comodato**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. *Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. *Erika Yadira González Gómez*; como área usuaria: El Q.C.B. *Eleazar Vera Puente*, representante del Laboratorio Estatal de Salud Pública, la Q.C.B. *Sandra Luz Garza Galvan*, representante del Hospital de Linares, la Q.C.B. *Nancy Carolina Prado Segura*, representante del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, la Q.C.B. *Diana Dávila González*, representante del Hospital de Sabinas Hidalgo, la Q.C.B. *Gloria Santos Gamboa* y la Dra. *Beatriz Aurora Lee González*, representantes del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el Lic. *Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. *Martha Patricia Gámez Hernández*, Jefa del Departamento de Adquisiciones y la Lic. *Nancy Natale de León Rodríguez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de proveedores estando presentes: **Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V.**, representada por el C. *René Gerardo Salazar Robledo* e **Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V.**, representada por el C. *José Francisco Martínez Pacheco*.



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	NUMERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 8, SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA. SOLICITAMOS QUE PARA CONTAR CON CERTEZA DEL RESPALDO TÉCNICO Y EL ABASTO OPORTUNO DE LOS INSUMOS POR PARTE DEL FABRICANTE, SEA REQUISITO OBLIGATORIO QUE LA CARTA DEBA SER PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE, YA QUE EL ABASTO OPORTUNO DE INSUMOS Y REFACCIONES DE LOS EQUIPOS, SOLAMENTE PUEDE SER GARANTIZADO POR ÉSTE Y NO POR ALGÚN DISTRIBUIDOR MAYORISTA. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN VIRTUD DE QUE SE PRETENDE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDURIA.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 2:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. EXISTEN DOS INSTANCIAS EN DONDE SE MENCIONA EL CONCEPTO "PAQUETE" : "EL GANADOR DE ESTE PAQUETE DEBERA PROPORCIONAR, ADEMÁS DE LOS ANALIZADORES EN COMODATO, LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLINICOS" Y "CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SISTEMA QUE DEBE PROPORCIONAR EL GANADOR DEL PAQUETE". ENTENDEMOS QUE EL CONCEPTO "PAQUETE" SE REFIERE AL CONJUNTO DE PARTIDAS INTEGRADAS POR LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13 Y 14. YA QUE ES NECESARIO PARA QUE LA COMPAÑÍA GANADORA DE ESTAS PARTIDAS PUEDA INSTALAR LAS COMPUTADORAS E INTERFASES DE EQUIPOS Y EL SISTEMA INFORMÁTICO EN TODOS LOS HOSPITALES Y JURISDICCIONES. ASÍ ENTONCES LA ASIGNACION DE ESTAS PARTIDAS SERIA EN "PAQUETE". ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACION?
Respuesta:	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA ASIGNACION SERA POR PARTIDA, CONFORME A LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Pregunta 3:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, I QUÍMICA CLÍNICA, ELECTROLITOS, INMUNOLOGÍA, PRUEBAS ESPECIALES (PCR ALTA SENSIBILIDAD): PARTIDAS 1, 2, 5 Y 7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA" Y 2 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPOS CON CAPACIDAD DE ENSAYOS DE HASTA 1400 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO (PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA" Y HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL). EQUIPO MODULAR QUE COMBINE QUÍMICA, ELECTROLITOS E INMUNOLOGÍA. SISTEMA AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA DETERMINAR PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA, QUÍMICA CLÍNICA E ISE PARA ELECTROLITOS. METODOLOGÍAS DE FOTOMETRÍA,

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



POTENCIOMETRÍA Y TURBIDIMETRÍA. TIPO DE MUESTRAS: PLASMA, SUERO, ORINA Y CSF. CON ALMACENAMIENTO DE DATOS DE HASTA 50,000 RESULTADOS DE PACIENTES. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA CONSERVACIÓN DE REACTIVOS INTEGRADO. REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 1.5-35 µL, 5 µL EN PROMEDIO. CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. CAPACIDAD PARA 65 POSICIONES DE REACTIVOS CON REFRIGERACIÓN A BORDO Y 215 MUESTRAS A BORDO EN QUÍMICA CLÍNICA Y 135 EN INMUNOLOGÍA. MEDICIÓN DE ISE POR MEDIO DE UN CHIP INTEGRADO (ICT). INTERFERENCIA CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVA DE <0.1 PPM. SISTEMA CON 186 CUBETAS REUTILIZABLES EN QUÍMICA CLÍNICA Y 1000 CUBETAS DESECHABLES EN INMUNOLOGÍA. CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICAS DE LEVY JENNINGS INTEGRADO. CONSUMO DE AGUA DE 45 LITROS/HORA DURANTE LA OPERACIÓN NORMAL. INVENTARIO DE REACTIVOS Y SOLUCIONES A BORDO. QUE CUENTE CON DETECCIÓN DE BURBUJAS Y COAGULOS. SOFTWARE EN ESPAÑOL. INTERFASE BI-DIRECCIONAL. SERIAL RS 232. PC MONITOR, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADA O ADICIONAL. CON REGULADOR DE VOLTAJE. PANTALLA TOUCHSCREEN. REACTIVOS Y EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE SER DE LA MISMA MARCA. CUENTE CON SISTEMA DE REPORTE DE RESULTADOS EN UNA IMPRESORA EXTERNA AL EQUIPO. SE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO CLÍNICO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA. SE DEBERÁ INSTALAR EQUIPO DE RESPALDO/URGENCIAS PARA LOS 2 LABORATORIOS PARA EL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA DE IGUAL O INFERIOR CAPACIDAD AL EQUIPO DE RUTINA. AMBOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR INTERFASADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO. **EN EL APARTADO DE INMUNOLOGÍA EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR POR LO MENOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** EQUIPOS CON CAPACIDAD DE ENSAYOS DE 200 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO. EQUIPO CON CAPACIDAD DE PROCESAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS. SISTEMA AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA DETERMINAR PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA. CAPACIDAD MÍNIMA PARA 77 INMUNOENSAYOS PROGRAMADOS MEDIANTE QUIMIOLUMINISCENCIA. CAPACIDAD DE TRABAJAR 24 HORAS DEL DÍA. RANDOM ACCESS. CON INVENTARIO DE REACTIVOS. QUE CUENTE CON GRADILLAS PARA MUESTRAS DE 5 POSICIONES. PRESENTACIÓN DE REACTIVOS: 100 PRUEBAS. CAPACIDAD DE MUESTRAS URGENTES. DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO Y DE COAGULO. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. QUE CUENTE CON CAPACIDAD PARA 135 MUESTRAS A BORDO. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. TODOS LOS REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. CAPAZ DE SER INTERFASADO. CUENTE CON SISTEMA DE REPORTE DE RESULTADOS EN UNA IMPRESORA EXTERNA AL EQUIPO. SOFTWARE EN ESPAÑOL. PC MONITOR, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADA O ADICIONAL. CON REGULADOR DE VOLTAJE. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. AMBOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR INTERFASADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Respuesta:	SI, SE ACEPTA, SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR POR LOS DEMÁS LICITANTES UNO U OTRO EQUIPO DEL QUE REFIERE EL LICITANTE O EL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
Pregunta 4:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, I QUÍMICA CLÍNICA, ELECTROLITOS, INMUNOLOGÍA, PRUEBAS ESPECIALES (PCR ALTA

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]



	<p>SENSIBILIDAD): PARTIDAS 1, 2, 5 Y 7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTOS PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HOSPITAL GRAL. DE DR. ARROYO, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, CSU NUEVA MORELOS, CSU TERMINAL, CSU ARTURO B. DE LA GARZA, CSU INSURGENTES, JURISDICCIÓN SANITARIA No. 5 CSU ANAHUAC, JURISDICCIÓN SANITARIA No. 6 CSU CADEREYTA, CLÍNICA TIERRA Y LIBERTAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA AUTOMATIZADO DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA DETERMINAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS. METODOLOGÍAS: QUÍMICA SECA (QUÍMICA) Y POTENCIOMETRÍA (ELECTROLITOS). VELOCIDAD DE 350 PRUEBAS/HORA MÍNIMO. TODOS LOS REACTIVOS LISTOS PARA SU USO EN LAMINILLAS REACTIVAS. VOLUMEN DE MUESTRA 10 µL. CAPACIDAD PARA ANALIZAR MUESTRAS DE SUERO, PLASMA, ORINA, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. QUE UTILICE PUNTILLAS DESECHABLES PARA LA TOMA DE MUESTRAS. CAPACIDAD DE 40 MUESTRAS A BORDO EN 4 GRADILLAS PARA 10 MUESTRAS CADA UNA. SISTEMA CON CONTROL DE TEMPERATURA DE REACCIÓN DE 37°C. CONTROL DE CALIDAD CONGRÁFICAS DE LEVIN JENNINGS INTEGRADO. LOS REACTIVOS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DEL USUARIO (PRE-DILUCIONES, PRETRATAMIENTO, MEZCLAS.). SOFTWARE EN ESPAÑOL. INTERFASE BI-DIRECCIONAL, SERIAL RS 232. PC MONITOR, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADA O ADICIONAL, CONREGULADOR DE VOLTAJE. PANTALLA TOUCH SCREEN. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVO. SISTEMA DE INFORMÁTICA, SOFTWARE Y MANUALES EN ESPAÑOL. REACTIVOS Y EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN DE SER DE LA MISMA MARCA. CUENTE CON SISTEMA DE REPORTE DE RESULTADOS EN UNA IMPRESORA EXTERNA AL EQUIPO. SE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO CLÍNICO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA. DEBERÁ CONTEMPLARSE LA DOTACIÓN DE SUEROS CONTROL A DOS NIVELES PARA EL CONTROL DE CALIDAD. LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR INTERFASADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, SE ACEPTA SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR POR LOS DEMAS LICITANTES UNO U OTRO EQUIPO DEL QUE REFIERE EL LICITANTE O EL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.</p>
<p>Pregunta 5:</p>	<p>ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, II EQUIPOS PARA HEMATOLOGÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA", 2 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL, ASÍ COMO UN EQUIPO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HOSPITAL GRAL. DE DR. ARROYO, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, JURISDICCIONES 1 Y 4 Y CLÍNICA TIERRA Y LIBERTAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRINCIPIO DE MEDICIÓN: MÉTODO DE ANÁLISIS ÓPTICO (LÁSER) DE ÁNGULO DUAL Y CON TECNOLOGÍA MAPSS ÓPTICO DE 4 ÁNGULOS PARA BLANCOS Y DIFERENCIAL. 4 REACTIVOS INCLUYENDO RETICULOCITOS. ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR POR LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE: 23 PARÁMETROS. CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES: NOC, WOC, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



	MCHC, RDW, RETIC#, RETIC%, PLT, MPV. ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 84 MUESTRAS POR HORA. VOLUMEN DE MUESTRA: 150 MCL MODO ABIERTO. REPORTE DE RESULTADOS EN GRÁFICAS, NÚMEROS ABSOLUTOS O POR CIENTO, TANTO EN LA PANTALLA COMO EN EL PAPEL. MONITOR E IMPRESORA INTEGRADOS O EXTERNOS. HASTA 500 ARCHIVOS DE CONTROL DE CALIDAD. QUE CUENTE CON AUTOMUESTREADOR INTEGRADO. ALMACÉN DE DATOS DE 10000 RESULTADOS ALMACENADOS CON GRÁFICAS. CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE. CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. SOFTWARE EN ESPAÑOL. REGULADOR DE VOLTAJE. SE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO CLÍNICO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA. LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR INTERFASADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	SI, SE ACEPTA SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR POR LOS DEMAS LICITANTES UNO U OTRO EQUIPO DEL QUE REFIERE EL LICITANTE O EL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
Pregunta 6:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, III EQUIPOS PARA UROANALISIS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA" Y UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO. TECNOLOGÍA: GRAVEDAD ESPECÍFICA POR ÍNDICE DE REFRACCIÓN, ASPECTO POR MEDICIÓN DE TRANSMITANCIA Y DISPERSIÓN DE LUZ, COLOR POR FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA. ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR: LOS SOLICITADOS PH, GLUCOSA, PROTEÍNAS, SANGRE CUERPOS CETÓNICOS, BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, NITRITOS, LEUCOCITOS. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS: 200 MUESTRAS EN 53 MINUTOS. CAPACIDAD DE RACKS DE 10 MUESTRAS POR RACK. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 MUESTRAS EN UNA CORRIDA SIN SUPERVISIÓN. ENTRADA INDEPENDIENTE PARA MUESTRAS URGENTES. CAPACIDAD DE MEMORIA PARA 1000 PACIENTES Y 200 CONTROLES/CALIBRACIONES. INTERFASE ASTM. SOFTWARE EN ESPAÑOL. REGULADOR DE VOLTAJE (NO BREAK). ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ INTERFASAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE INFORMÁTICA DEL LABORATORIO Y PROPORCIONAR UNA ESTACIÓN DE TRABAJO SEGÚN LO DESCRITO. SISTEMA DE REPORTE CON IMPRESORA INTERNA Y/O EXTERNA. SE DEBERÁ INSTALAR EQUIPO DE RESPALDO/URGENCIAS PARA LOS 2 LABORATORIOS DE IGUAL O INFERIOR CAPACIDAD AL EQUIPO DE RUTINA. EL LICITANTE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL ÁREA DE ORINAS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	SI, SE ACEPTA SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR POR LOS DEMAS LICITANTES UNO U OTRO EQUIPO DEL QUE REFIERE EL LICITANTE O EL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
Pregunta 7:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, III EQUIPOS PARA UROANALISIS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

	<p>INSTRUMENTO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE SABINAS, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO, CLÍNICA TIERRA Y LIBERTAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL EGO. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA. SEMIAUTOMATIZADO. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS: 500 TIRAS POR HORA. VELOCIDAD DE TIEMPO DE LECTURA: MÁXIMO 1 TIRA CADA 7 SEG. DEPÓSITO PARA DESECHO DE TIRAS REACTIVAS. PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO INCLUIDA. SOFTWARE EN ESPAÑOL. REGULADOR DE VOLTAJE (NO BREAK). CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 500 RESULTADOS DE MUESTRAS Y 200 RESULTADOS DE CONTROLES. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ INTERFASAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO Y PROPORCIONAR UNA ESTACIÓN DE TRABAJO SEGÚN LO DESCRITO. SISTEMA DE REPORTE CON IMPRESORA INTERNA Y/O EXTERNA. EL LICITANTE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL ÁREA DE ORINAS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, SE ACEPTA SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR POR LOS DEMAS LICITANTES UNO U OTRO EQUIPO DEL QUE REFIERE EL LICITANTE O EL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.</p>
<p>Pregunta 8:</p>	<p>ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PRUEBAS DE COAGULACIÓN. MENCIONA LA CONVOCANTE QUE EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR 2 EQUIPOS DE COAGULACIÓN (PARA HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" Y HOSPITAL REGIONAL DE ALTAESPECIALIDAD MATERNO-INFANTIL) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PUNTO 3," CON 4 CANALES DE LECTURA". SE SOLICITA EL LICITANTE PROPONER UN EQUIPO CON 2 CANALES DE LECTURA PERO QUE NO AFECTE LA VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA EN LA LICITACIÓN DE 60 PBAS/HR. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, SE ACEPTA</p>
<p>Pregunta 9:</p>	<p>ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PRUEBAS DE COAGULACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 6 EQUIPOS DE COAGULACIÓN (HOSPITALES: GRAL. DE DR. ARROYO, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS) Y CLÍNICA TIERRA Y LIBERTAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN: CROMOGÉNICAS Y COAGULOMÉTRICAS. CAPACIDAD PARA DETERMINAR: TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA, TIEMPO DE TROMBINA, FACTORES DE LA COAGULACIÓN. CAPACIDAD DE 60 CUBETAS A BORDO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA REACTIVOS PARA 4 POSICIONES. ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 1500 PRUEBAS. VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 50 ML. VELOCIDAD DE 60 RESULTADOS/HORA DE TP. 6 CANALES PROGRAMABLES. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD LEVEY-JENNINGS. IMPRESORA INTEGRADA. CON PUERTO DE SALIDA PARA CONECTARSE A INTERFASE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL. EL PROVEEDOR GANADOR</p>

[Handwritten signature]



	DEBERÁ INTERFASAR EL EQUIPO CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO QUE INSTALARÁ EL GANADOR DEL PAQUETE PRINCIPAL. DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE CONTEMPLA EL EQUIPO. SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: TP Y APTT. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	SI, SE ACEPTA SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR POR LOS DEMAS LICITANTES UNO U OTRO EQUIPO DEL QUE REFIERE EL LICITANTE O EL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
Pregunta 10:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA INMUNOHEMATOLOGIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA" Y UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS, ANTICUERPOS, ANTIERITROCITOS, ANTIGLOBULINA HUMANA DIRECTA Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TARJETAS DE GEL. EQUIPO QUE PERMITA REALIZAR DE MANERA AUTOMÁTICA E INTEGRADA LOS SIGUIENTES PROCESOS: IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS, HOMOGENIZACIÓN DE ERITROCITOS REACTIVOS, DILUCIÓN Y DISPENSADO DE MUESTRAS Y REACTIVOS INCUBACIÓN A LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL TIPO DE PRUEBA. CENTRIFUGACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS TARJETAS LECTURA AUTOMÁTICA DE LAS TARJETAS. INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS. UTILIZACIÓN DE CUALQUIER TAMAÑO DE TUBO PRIMARIO. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. ACCESORIOS: COMPUTADORA COMPATIBLE CON SOFTWARE GRAFICO EN ESPAÑOL, EN AMBIENTE WINDOWS. CON INTERFASE BIDIRECCIONAL PARA CONECTARSE A COMPUTADORA CENTRAL. REACTIVOS Y CONSUMIBLES: TARJETAS DE GEL DE 8 POZOS PARA PRUEBAS INMUNOHEMATOLOGICAS. DILUYENTES PARA TARJETAS DE GEL. SOLUCIONES CONCENTRADAS DE LAVADO. CÉLULAS EN SUSPENSIÓN 0.8 %. LAS PRUEBAS SOLICITADAS SON: GRUPOS SANGUINEOS ABO Y RH, PRUEBAS CRUZADAS Y COOMBS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	SI, SE ACEPTA SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR POR LOS DEMAS LICITANTES UNO U OTRO EQUIPO DEL QUE REFIERE EL LICITANTE O EL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
Pregunta 11:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PARTIDA 12 REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS. NO SE ENCUENTRAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA ESTA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA", UNO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL, UNO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SABINAS Y UNO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE DR. ARROYO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO AUTOMATIZADO. SISTEMA DE DETECCIÓN BASADO EN FLUORESCENCIA. INDICACIÓN DE ESTADO DE LOS VIALES EN PANTALLA. SISTEMA DE

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



	<p>INCUBACIÓN Y AGITACIÓN INTEGRADO. CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA. CON CAPACIDAD DE INGRESAR MANUALMENTE LOS FRASCOS, CON LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN CASO DE SER NECESARIO. CON SISTEMA DE CÓMPUTO ANEXO PARA MANEJO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. CAPACITACIÓN AL PERSONAL POR EL TIEMPO NECESARIO. LOS CONSUMIBLES DEBERÁN INCLUIRSE CON LA ENTREGA DEL REACTIVO EN CANTIDADES EQUIVALENTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO POR EL LICITANTE CON REGISTRO EN BITÁCORA DE MANTENIMIENTO INTERNA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN UN MÁXIMO DE 6 HRS. SE PROPORCIONARÁN MEDIOS ADICIONALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD, MÍNIMO 3 POR MES. PROPORCIONE AL LABORATORIO LOS MEDIOS DE CULTIVO (HEMOCULTIVOS) EN LAS PRESENTACIONES INDICADAS: ADULTO AERÓBICO, ADULTO ANAERÓBICO Y PEDIÁTRICO. LOS FRASCOS QUE SEAN DE VIDRIO. DEBERA EL PROVEEDOR DE MICROBIOLOGIA PROPORCIONAR UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, (MINISPLITS) CON CAPACIDAD SEGÚN LO REQUIERA CADA HOSPITAL. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
<p>Pregunta 12:</p>	<p>ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PARTIDA 13 REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA. NO SE ENCUENTRAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA ESTA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA", UNO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL, UNO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SABINAS, UNO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE DR. ARROYO, Y UNO PARA EL HOSPITAL GRAL. DE GALEANA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O SUSCEPTIBILIDAD DE BACTERIAS AEROBIAS, ANAEROBIAS Y LEVADURAS Y EN MUESTRAS DE PACIENTES ESTÉRILES O CONTAMINADAS. TECNOLOGÍA COLORIMÉTRICA Y TURBIDIMÉTRICA QUE MIDE LA ACTIVIDAD METABÓLICA Y ENZIMÁTICA POR MEDIO DE SUSTRATOS PRESENTES EN CADA PLACA. CAPACIDAD DE 120 TARJETAS (H. METROPOLITANO) Y 60. TARJETAS (H. MATERNO INFANTIL, SABINAS, DR. ARROYO Y GALEANA). AMPLIA BASE DE DATOS DE MICROORGANISMOS. SOFTWARE EN ESPAÑOL. AMPLIO MENÚ EPIDEMIOLÓGICO. TAXA ACTUALIZADA.</p> <p>SISTEMA EXPERTO: PERMITE LA APROPIADA INTERVENCIÓN PARA ORGANISMOS CON PATRONES DE RESISTENCIA INUSUALES. SUPRESIÓN DE ANTIBIÓTICOS Y CASCADA. VALIDACIÓN DE RESULTADOS. ESTADÍSTICAS (EXPORTA DATOS A EXCEL). INTERFASE BIDIRECCIONAL. IDENTIFICACIÓN DE LAS PLACAS POR LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS. SUSCEPTIBILIDAD DE ACUERDO A CRITERIOS CLSI. IMPRESORA INCLUIDA. EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ INTERFASAR EL EQUIPO CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO QUE INSTALARÁ EL GANADOR DEL PAQUETE PRINCIPAL. PROPORCIONE UN REFRIGERADOR ELÉCTRICO, PARA CADA HOSPITAL, FIJO PARA PRESERVAR REACTIVOS A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 GRADOS CENTÍGRADOS, CAPACIDAD DE 21 +/- 2 PIES CÚBICOS, CON PUERTAS DE CRISTAL, SIN CONGELADOR Y CUENTE AL MENOS CON TRES ENTREPAÑOS, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, SISTEMA DE ALARMA ACÚSTICA Y VISUAL EN CASO DE FALLA. IDENTIFICACIÓN DE NHI, ANI Y LEVADURAS EN EL MISMO EQUIPO. OFREZCA AL PERSONAL EL NÚMERO DE CAPACITACIONES NECESARIAS EN CADA UNA DE LOS 6 TURNOS CON LOS</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

	<p>QUE CUENTA EL LABORATORIO, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO Y CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE UNA SEMANA. ADEMÁS DE CAPACITACIÓN REQUERIDA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ENTREGARÁ CONSTANCIA AL PERSONAL CAPACITADO. LA CONSTANCIA DEBERÁ SER PERSONALIZADA E INCLUIR EL NÚMERO DE HORAS DE DURACIÓN. LOS CONSUMIBLES DEBERÁN INCLUIRSE CON LA ENTREGA DEL REACTIVO EN CANTIDADES EQUIVALENTES. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE CONTEMPLA EL EQUIPO Y LOS ANÁLISIS CLÍNICOS INSTALADOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO POR EL PROVEEDOR. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN UN MÁXIMO DE 6 HRS. LAS PRUEBAS INCLUIDAS SON: IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS, IDENTIFICACIÓN DE GÉRMEANES ANAEROBIOS, IDENTIFICACIÓN DE GÉRMEANES DE CRECIMIENTO "EXIGENTE", SENSIBILIDAD GRAM POSITIVA Y GRAM NEGATIVA, IDENTIFICACIÓN DE NEISSERIA Y HAEMOPHILUS, IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
<p>Pregunta 13:</p>	<p>ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PARTIDA 14 BOLSA PARA SANGRADO DONADORES. NO SE ENCUENTRAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA ESTA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSAS QUE DEBERAN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOLSA TRIPLE PARA RECOLECTAR Y FRACCIONAR SANGRE. UNA PARA RECOLECTAR 450 ML. CON 63 ML. Ó 500 ML CON 70 ML. DE SOLUCIÓN CPD-ADENINA CON TUBO COLECTOR PRIMARIO CON AGUJA CALIBRE 15 Ó 16, DOS BOLSAS UNIDAS POR TUBERÍAS, CADA UNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 300 ML., UNA DE ELLAS FABRICADA EN PLÁSTICO QUE PERMITA EL INTERCAMBIO GASEOSO NECESARIO PARA CONSERVAR LAS PLAQUETAS POR 5 DÍAS. BOLSA CUÁDRUPLE PARA RECOLECTAR Y FRACCIONAR SANGRE. UNA PARA RECOLECTAR 450 ML. CON 63 ML. Ó 500 ML CON 70 ML. DE SOLUCIÓN CPD-ADENINA CON TUBO COLECTOR PRIMARIO CON AGUJA CALIBRE 15 Ó 16, TRES BOLSAS UNIDAS POR TUBERÍAS, CADA UNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 300 ML., UNA DE ELLAS FABRICADA EN PLÁSTICO QUE PERMITA EL INTERCAMBIO GASEOSO NECESARIO PARA CONSERVAR LAS PLAQUETAS POR 5 DÍAS. SE DEBERÁN PROPORCIONAR: 4 REFRIGERADORES CON SISTEMA DE ALARMA E INDICADORES VISUALES Y AUDITIVAS CON BATERÍA DE RESPALDO DE DOS HORAS (HOSPITAL METROPOLITANO, MATERNO INFANTIL, SABINAS HIDALGO Y C.E.T.S.) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD PARA 144 UNIDADES DE SANGRE COMO MÍNIMO. CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON REGISTRO DE TEMPERATURAS DÍA/SEMANA. VOLUMEN EFECTIVO DE ALMACENAMIENTO 300 LTS. 6 CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE. REFRIGERADOR LIBRE DE CFC. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA. REGISTRO GRÁFICO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. CERRADURA TIPO PALANCA PARA UN BLOQUEO SENCILLO Y SEGURO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO. 7 BALANZAS AGITADORAS (3 HOSPITAL METROPOLITANO, 2 PARA EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL, 1 PARA EL HOSPITAL INFANTIL Y SABINAS HIDALGO) PARA BOLSAS DE SANGRE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RECOLECTOR AUTOMÁTICO DE SANGRE CON MOVIMIENTO OSCILATORIO CONTINUO CON CHAROLA MAGNÉTICA PARA COLOCAR BOLSA DE SANGRE. PANTALLA ILUMINADA CON</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



	BARRA INDICADORA DE PROCESO DE DONACIÓN, TIEMPO DE DONACIÓN, FLUJO Y VOLUMEN RECOLECTADO. ALARMAS AUDIBLES Y LED INDICADOR. ALÁRMAS DE SEGURIDAD PROGRAMABLES DE FLUJO, RETRASO EN VENOPUNCIÓN Y AVISO AUDIBLE AL TÉRMINO DE LA FLEBOTOMÍA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO. 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA Y UNO PARA EL HOSPITAL DE SABINAS HIDALGO. 5 SILLONES DE EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA DONADORES, (1 HOSPITAL METROPOLITANO, 2 HOSPITAL INFANTIL Y 1 C.E.T.S. Y PARA EL HOSPITAL SABINAS HIDALGO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SILLÓN DE ALTA DURABILIDAD. CON CONTROL ELÉCTRICO. CON SOPORTE PARA COLOCACIÓN DE BALANZA MEZCLADORA, GRADILLAS Y MATERIAL PARA FLEBOTOMÍA. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA, ACLARANDO QUE ES UNA BALANZA PARA EL C.E.T.S., Y NO PARA EL HOSPITAL INFANTIL.
Pregunta 14:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EQUIPO PARA PARTIDAS 1, 2, 5 Y 7, EQUIPO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA INMUNOHEMATOLOGIA, ASÍ COMO NUMERAL 1.1.1. Y NUMERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 10. EN EL ANEXO 1A SOLICITAN EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS, Y EN LOS PUNTOS ANTERIORES SOLICITAN UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 3 AÑOS. ANTE ESTA SITUACIÓN Y DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS YA CUENTAN CON ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 3 AÑOS, Y CONSIDERANDO QUE LA ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS PUEDE REPERCUTIR EN EL SERVICIO PROPORCIONADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE REQUIERA QUE LOS EQUIPOS A INSTALAR SEAN NUEVOS, YA QUE ESTO SERÍA EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	SI, SE ACEPTA SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR POR LOS DEMAS LICITANTES UNO U OTRO EQUIPO DEL QUE REFIERE EL LICITANTE O EL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE DEBERÁ SER UN EQUIPO CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 3 AÑOS.
Pregunta 15:	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EQUIPO PARA PARTIDAS 1, 2, 5 Y 7, EQUIPO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA INMUNOHEMATOLOGIA, ASÍ COMO NUMERAL 1.1.1. Y NUMERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 10. PARA EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA ANTERIOR PREGUNTA SEA AFIRMATIVA, SOLICITAMOS SE PUEDA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS NUEVOS A 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERE TIEMPO ADICIONAL PARA LA IMPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS NUEVOS, Y CONSIDERANDO QUE ÉSTE SERÍA EL MÁXIMO PARA SU INSTALACIÓN, PUDIENDO DARSE EL CASO DE QUE LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS SEA INSTALADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA LÍMITE. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN VIRTUD DE QUE EN LA RESPUESTA ANTERIOR NO SE ESTÁ EXIGIENDO OFERTAR EQUIPOS NUEVOS.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]



LICITANTE: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

<p>Pregunta 1:</p>	<p>PUNTO 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 1.1.1 EN ESTE PUNTO SE MENCIONA QUE LOS EQUIPOS EN COMODATO NO DEBERAN TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS. Y EN EL ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO MENCIONA QUE LOS EQUIPOS NO DEBERAN DE TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS. DEBEMOS SUPONER QUE LA ANTIGÜEDAD SOLICITADA ES DE EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS DADO QUE EL DESGASTE DEL EQUIPO HA SIDO MENOR CON ESTE TIEMPO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS EQUIPOS EN COMODATO DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS.</p>
<p>Pregunta 2:</p>	<p>PUNTO 1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA, INCISO I) REFERENTE A LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS MENCIONAN QUE DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CADUCIDADES MENORES AL AÑO CON EL COMPROMISO DE CANJEARLOS SI NO SE LLEGAN A CONSUMIR. DADO QUE HAY REACTIVOS QUE POR SU NATURALEZA BIOLÓGICA NO PODRÍAN CUMPLIR CON LA CADUCIDAD SOLICITADA EN BASES. ¿SE ACEPTA?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, SE ACEPTA UNA CADUCIDAD MÁXIMA DE 8 MESES, ENTREGANDO CARTA COMPROMISO DE CANJE DEL REACTIVO CON MES DE ANTICIPACION AL VENCIMIENTO.</p>
<p>Pregunta 3:</p>	<p>NUMERAL. 1.2. PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. 1.2.1. PERÍODO DE ENTREGA: PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL LICITANTE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. Y EN EL NUMERAL 3, INCISO C, PUNTO 11 DICE: CARTA COMPROMISO DE ENTREGAR LOS EQUIPOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS A MÁS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. CONTAREMOS CON HASTA 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SE MODIFICA EL PUNTO REFERENTE A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL CUAL DEBERA SER DE 7 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p>
<p>Pregunta 4:</p>	<p>PUNTO 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 18. SOLICITAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO, ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS.</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

	LOS DOCUMENTOS DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. SOLO SE DEBERÁN PRESENTAR COPIA DEL ORIGINAL Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL SIN NECESIDAD DE ESTAR CERTIFICADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
Respuesta:	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ PRESENTAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, RESERVANDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD EN CUALQUIER MOMENTO.
Pregunta 5:	PUNTO 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 18. SOLICITAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO, ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS. LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS QUE SOLICITAN SE REFIEREN A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
Respuesta:	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
Pregunta 6:	PUNTO 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 17. SOLICITAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO, ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIEREN CON EL TERMINO DE MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS?
Respuesta:	SE ELIMINA DICHO PUNTO.

LICITANTE: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	ANEXO 1A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO NO SE ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA LA PARTIDA 6 DEL ANEXO 1. CORRESPONDIENTE A REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO EL CUAL DETERMINA: PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, LACTATO, GLUCOSA, HEMATOCRITO Y PARÁMETROS CALCULADOS EN SANGRE TOTAL HEPARINIZADA Y REQUIERE ÚNICAMENTE DE UN SOLO CARTUJO MULTIPRUEBAS DONDE SE ENCUENTREN INTEGRADAS LAS SOLUCIONES, REACTIVOS, SENSORES, BOLSA DE DESECHO, AGUJA TOMA MUESTRAS, GASES MEZCLADOS, SOLUCIONES CALIBRADORAS Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL ANALIZADOR CALIBRE ¿SE ACEPTA?



Respuesta:	SI, SE ACEPTA OFERTE SU TECNOLOGÍA, SIN LIMITAR LA POSIBILIDAD DE QUE OTROS LICITANTES OFERTEN LA PROPIA.
Pregunta 2:	ANEXO 1A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO NO SE ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA LA PARTIDA 5 DEL ANEXO 1. CORRESPONDIENTE A REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) PARA LA CLAVE 5019390010 DEL ANEXO 1-B SOLICITAN GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS), SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO EL CUAL DETERMINA: PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, LACTATO, GLUCOSA, HCT, THB (HEMOGLOBINA TOTAL), O2HB (ÓXIHEMOGLOBINA), COHB(CARBOXIHEMOGLOBINA), METHB(METAHEMOGLOBINA), RHB(RIBOXIHEMOGLOBINA), SO2 (SATURACIÓN DE OXÍGENO), Y PARÁMETROS CALCULADOS EN SANGRE TOTAL HEPARINIZADA, QUE UTILIZA ÚNICAMENTE UN CARTUCHO QUE INTEGRA REACTIVOS, CALIBRADORES, BIOSENSORES, GASES, AGUJA TOMA MUESTRA, PARA SU FUNCIONAMIENTO; ASÍ COMO CONTENEDOR DE DESECHOS EN UN SOLO CARTUCHO. ¿SE ACEPTA?
Respuesta:	SI, SE ACEPTA OFERTE SU TECNOLOGÍA, SIN LIMITAR LA POSIBILIDAD DE QUE OTROS LICITANTES OFERTEN LA PROPIA.
Pregunta 3:	ANEXO 1A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO NO SE ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA LA PARTIDA 8 DEL ANEXO 1. CORRESPONDIENTE A REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II HEP B, HEP C, T.PALLIDUM, TRIPANOSOMA CRUZY Y VIH. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.-SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA ANÁLISIS INMUNOLÓGICO. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: ELISA, FIA, FPIA, 2.-MEIA, QUIMIOLUMINISCENCIA, O ELECTROLUMINISCENCIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 3.-CON CAPACIDAD PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE (VIH, HBSAG, HCV, SIFILIS Y CHAGAS) EN EL MISMO EQUIPO. 4.-CAPACIDAD DE 135 MUESTRAS ABORDO CON POSICIONES PROGRAMABLES DE URGENCIAS. 5.-CAPACIDAD DE 25 POSICIONES DE REFRIGERACIÓN ABORDO. 6.-CAPACIDAD DE PROCESAR MUESTRAS URGENTES. 7.-VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO COMO MÍNIMO DE 200 PRUEBAS POR HORA. 8.-QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO Y GRAFICAS DE LEVEY-JENNINGS. ¿SE ACEPTA?
Respuesta:	SI, SE ACEPTA OFERTE SU TECNOLOGÍA, SIN LIMITAR LA POSIBILIDAD DE QUE OTROS LICITANTES OFERTEN LA PROPIA.
Pregunta 4:	ANEXO 1A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



	<p>NO SE ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA LA PARTIDA 11 ANEXO 1 CORRESPONDIENTE A REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE HBA1C. 2.-CON UNA VELOCIDAD DE TRABAJO MÍNIMA DE 20 PRUEBAS POR HORA. 3.-QUE PROCESA DE FORMA AUTOMATIZADA LAS PRUEBAS DE HEMOGLOBINA PARA LAS FRACCIONES A1C, A2 Y F(DUAL PROGRAM) 4.-CUANTIFICACIÓN EN PRESENCIA DE HBS, HBC Y HBF. 5.-ANÁLISIS DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO. 6.-CON CAPACIDAD DE COLOCAR AL MENOS 10 MUESTRAS A LA VEZ. 7.-QUE UTILICE LA METODOLOGÍA DE HPLC (CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN) <p>¿SE ACEPTA?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, SE ACEPTA OFERTE SU TECNOLOGÍA, SIN LIMITAR LA POSIBILIDAD DE QUE OTROS LICITANTES OFERTEN LA PROPIA.</p>
<p>Pregunta 5:</p>	<p>ANEXO 1A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO NO SE ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA PARTIDA 8 REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA 11.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA INFORMATICO PARTIDA 8 PARA LA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS.</p> <ol style="list-style-type: none"> A).- CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL APÉNDICE C (NORMATIVO) "INFORMES, DOCUMENTOS Y REGISTROS" DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 003 SSA2 1993 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. B).- DEBERÁ INTERFASAR CON EL AUTOANALIZADOR. C.-QUE PERMITA EL ENLACE NACIONAL PARA LOS REPORTES MENSUALES. D).-QUE BRINDE APOYO PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y CONTROL DE CALIDAD. <ol style="list-style-type: none"> 1.-INSTALACIÓN DE UNA RED DE CUANDO MENOS 4 COMPUTADORAS Y UN SERVIDOR E IMPRESORAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO TODO EL PROCESO (APARTE DE LO QUE NECESITA EL AUTOANALIZADOR). ADMISIÓN, SELECCIÓN, ESTUDIOS DEL DONADOR, CONTROL DE INVENTARIOS, CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTUDIOS DE PACIENTES (PRUEBAS CRUZADAS). 2.-CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE DICHO SISTEMA. 3.-SOPORTE TÉCNICO CON 24 HORAS COMO MÁXIMO EN TIEMPO DE RESPUESTA, DEBIENDO DE ENTREGAR UN PROGRAMA CALENDARIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL DEBERÁ SER INCLUIDO EN EL COSTO DEL REACTIVO ASÍ COMO PROTOCOLO A SEGUIR PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. <p>¿SE ACEPTA?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>SI, SE ACEPTA OFERTE SU TECNOLOGÍA, SIN LIMITAR LA POSIBILIDAD DE QUE OTROS LICITANTES OFERTEN LA PROPIA.</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Pregunta 6:	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO DICE: I QUÍMICA CLINICA, ELECTROLITOS, INMUNOLOGIA, PRUEBAS ESPECIALES (PCR ALTA SENSIBILIDAD): PARTIDAS 1, 2, 5 Y 7 LA NUMERACIÓN DE LAS PARTIDAS DEBE SER: 1, 2, 7 Y 10... ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
Respuesta:	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
Pregunta 7:	ANEXO 1A.-PRUEBAS DE COAGULACION: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS. EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR 2 EQUIPOS DE COAGULACIÓN (PARA HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" Y HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO-INFANTIL) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EN LA VIÑETA NO. 3 SOLICITA EQUIPO "CON 4 CANALES DE LECTURA" DEBIDO A LA ALTA PRODUCTIVIDAD DE DICHS HOSPITALES SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE PEDIR UN INSTRUMENTO CON 20 CANALES DE LECTURA INDEPENDIENTE Y UNA VELOCIDAD DE PROCESO DE 175 PRUEBAS POR HORA EN BASE AL TP, CON CAPACIDAD DE 40 MUESTRAS Y 22 REACTIVOS A BORDO; ESTO PARA PODER AGILIZAR EL TRABAJO DEL LABORATORIO ¿SE DEBERÁ OFERTAR UN INSTRUMENTO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS?
Respuesta:	SE PODRA OFERTAR EQUIPOS QUE ASEMEJEN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DEL SERVICIO Y SU ACEPTACIÓN ESTARÁ SUJETA A LA EVALUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. PODRÁ OFERTAR DICHA CARACTERISTICA, SIN QUE SE LIMITE LA POSIBILIDAD DE QUE SE OFERTE POR OTRO LICITANTE SU PROPIA TECNOLOGÍA.
Pregunta 8:	ANEXO 1A.- PRUEBAS DE COAGULACION: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS. EN LA VIÑETA 9 SOLICITA EQUIPO CON "INICIO AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN" ¿PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE REALICE EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CON UN "CLICK" EN LA PANTALLA DEL EQUIPO Y PROCESA DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA? ¿SE ACEPTA?
Respuesta:	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN LIMITAR LA POSIBILIDAD DE QUE OTROS LICITANTES OFERTEN LA PROPIA.
Pregunta 9:	ANEXO 1A.- PRUEBAS DE COAGULACION: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS. EN LA VIÑETA 6 SOLICITA EQUIPO "CAPAZ DE MEDIR FIBRINÓGENO" ¿SE DEBERÁ DE OFERTAR UN INSTRUMENTO CON CAPACIDAD DE REALIZAR FIBRINÓGENO A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA EL CUAL ES CORRELACIONABLE CON EL FIBRIÓGENO DE CLAUSS Y CON COSTO DE CERO PARA EL HOSPITAL?
Respuesta:	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN LIMITAR LA POSIBILIDAD DE QUE OTROS LICITANTES OFERTEN SU PROPIA TECNOLOGÍA.
Pregunta 10:	ANEXO 1A.- PRUEBAS DE COAGULACION: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS. SE HA DEMOSTRADO QUE EL ANÁLISIS CENTRIFUGO CON NEFELOMETRÍA DE LUZ PARA DETECTAR LA FORMACIÓN DE COAGULO LE CONFIERE AL COAGULOMETRO UNA

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



	SENSIBILIDAD IMPORTANTE EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y ESTO PERMITE DIAGNOSTICAR MÁS EFICIENTEMENTE CUALQUIER DEFICIENCIA DE FACTORES O PRESENCIA DE INHIBIDORES DE LA COAGULACIÓN ¿SE DEBERÁ OFERTA UN INSTRUMENTO CON CAPACIDAD DE DETECCIÓN DEL COAGULO POR NEFELOMETRÍA DE LUZ?
Respuesta:	SE PODRA OFERTAR EQUIPOS QUE ASEMEJEN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DEL SERVICIO Y SU ACEPTACIÓN ESTARÁ SUJETA A LA EVALUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. PODRÁ OFERTAR DICHA CARACTERISTICA, SIN QUE SE LIMITE LA PÓSIBILIDAD DE QUE SE OFERTE POR OTRO LICITANTE SU PROPIA TECNOLOGÍA.

----- G E N E R A L E S -----

El servidor Público que preside señala que la fecha del fallo de la presente convocatoria, será el día 14 de diciembre del presente año a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en el 2do. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 12 de diciembre del 2016, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en el 2do. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, a las 11:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta junta de aclaraciones, siendo las 12:30 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal, los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	
--	-----------------------------------	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL DE LINARES (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. SANDRA LUZ GARZA GALVAN	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. NANCY CAROLINA PRADO SEGURA	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL SABINAS HIDALGO (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. DIANA DÁVILA GONZÁLEZ	
REPRESENTANTE DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. GLORIA SANTOS GAMBOA	
REPRESENTANTE DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (COMO ÁREA USUARIA)	DRA. BEATRIZ AURORA LEE GONZÁLEZ	




Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. ELEAZAR VERA PUENTE	
--	----------------------------	---

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. MARTHA PATRICIA GÁMEZ HERNÁNDEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA, LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	C. RENÉ GERARDO SALAZAR ROBLEDO	

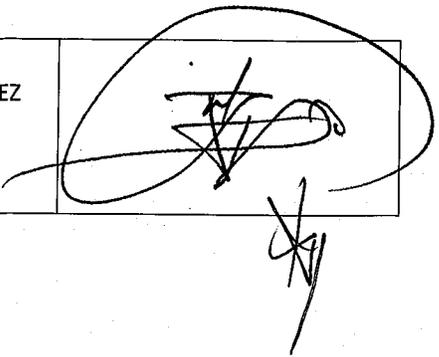
[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>C. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ PACHECO</p>	
--	---	---

X





